80328 Desinfektionsmittelständer inklusive Spender

KÖNIG & MEYER
Stands For Music

Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

TECHNISCHE DATEN

STATIV

- Höhe gesamt:	1280 mm
- Höhe Auflage:	820 mm
- Rundsockel:	ø 275 x 41 mm
- Grundrohr:	ø 20 x 800 mm
MATERIAL	
- Sockel:	Stahl, verzinkt, PA, TPE
- Grundrohr:	Stahl
OBERFLÄCHE	schwarz (-55), pulverbeschichtet
	reinweiß (-76), pulverbeschichtet

SPENDERHALTER

- Lochbilder zur Montage von Spendern:	
a. 500 ml:	40 x 169 mm
b. 1000 ml:	40 x 203 mm
- Tropfschale:	ø 70 x 47 mm
MATERIAL	
- Flaschenhalter:	Stahl, Polyamid
- Gewinde:	Stahl, Messing, Zink
OBERFLÄCHE	schwarz (-55), pulverbeschichtet
	reinweiß (-76), pulverbeschichtet

SPENDER

Ellbogenspender mit entnehmbarer PET-Flasche

- Abmessungen:	B x T x H = 83 x 160 x 243 mm
- Flascheninhalt:	Menge = 500 ml
MATERIAL	Alu, Stahl, ABS, PET

GEWICHT gesamt: 5,1 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit der Installation hängt ab von:

ALLGEMEIN
Vor Gebrauch Sichtprüfung vornehmen: beschädigte Bauteile dürfen nicht eingesetzt werden - bzw. erst nach einer qualifizierten Reparatur oder nach einem Austausch.

RUNDTSOCKEL
Aufgrund der Schwere vorsichtig handhaben, insbesondere nicht fallen lassen (Quetschgefahr).

MONTAGE
Auf feste Schraubverbindungen achten.

UNTERGRUND
Ständer nur auf geeigneten, d.h. ebenen und tragfähigen Untergründen abstellen.

TRAGLAST
Nur für passende 500ml-Flaschen; siehe oben TECHNISCHE DATEN.

UMGEBUNG
Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerren, Erschütterungen, Wind, Nässe etc.) sind zu vermeiden bzw. zu verhindern.

HANDHABUNG
Bei Richtungsänderungen der Spenderflasche stets den kompletten Ständer drehen. Niemals das Gewinde **b.2** des Spenderhalters **b** lösen.

MONTAGEANLEITUNG

Bitte Sichtprüfung vornehmen, ob alle Teile vollständig vorhanden und soweit erkennbar in Ordnung sind. Ebenfalls die erforderlichen Schlüssel zurechtlegen.

A. BESTANDTEILE

a Rundsockel
b Spenderhalter
b.1 Tropfschale ø 70 mm
b.2 Gewindebolzen M6
c Ellbogenspender mit PET-Flasche
d Grundrohr
Zubehörbeutel (6-80320-1-00)
e.1 Sicherungsmuttern M5-DIN985 (3x) - Schlüssel SW8
e.2 U-Scheibe ø 5,3 mm (3x)
e.3 Linsenkopfschraube M5 x 16 mm (3x) - Kreuzschlitz Z2

B. ABMESSUNGEN


u.a. Lochbild für Spendermontage:
A. 40 x 169 mm (für 500 ml Fla. -Spender im Lieferumfang)
B. 40 x 203 mm (für 1000 ml-Fla. -Spender nicht im LU)

C. STATIV

1.1 Rundsockel (mit Gummiring) **a** auf den Boden legen,
1.2 Grundrohr **d** mit dem Außengewinde bis zum Anschlag in den Rundsockel **a** eindrehen.

D. SPENDERHALTER und TROPFSCHALE

2.1 Gewindebolzen **b.2** des Spenderhalters **b** bis zum Anschlag in das Grundrohr **d** eindrehen.
2.2 Die Tropfschale **b.1** kann zur Reinigung entnommen werden. Anschließend die Schale von oben wieder in die Freimachung einpressen.

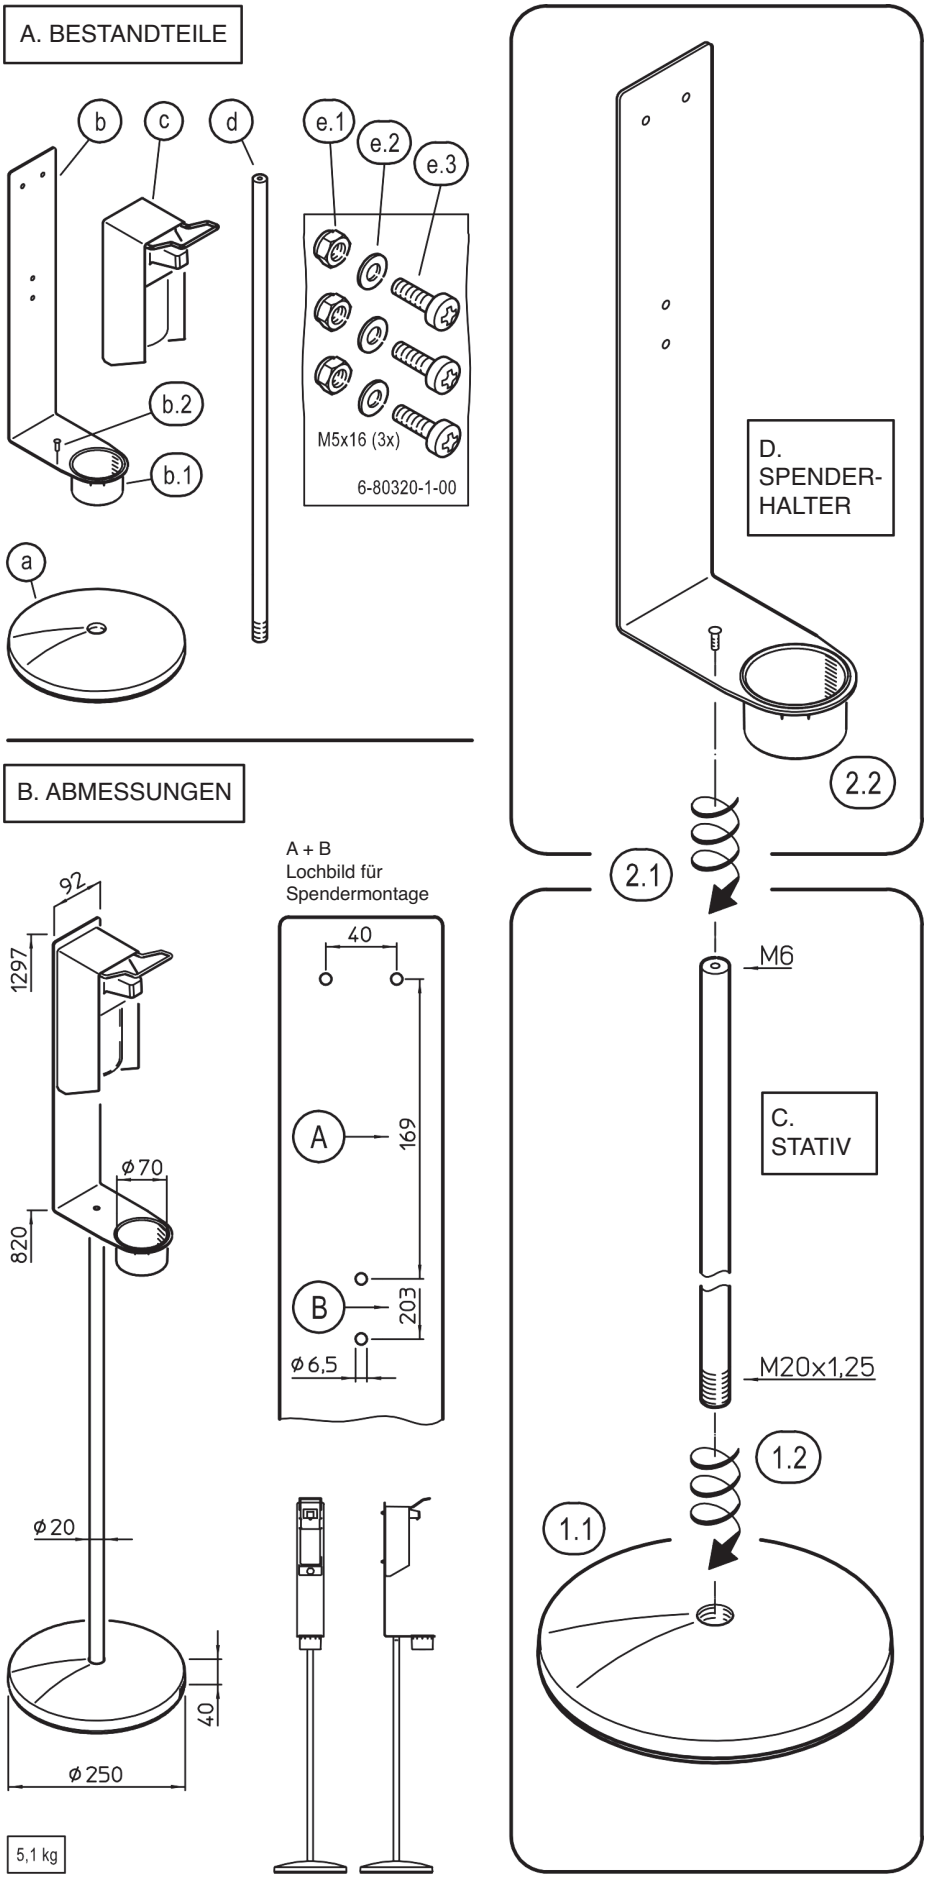

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
80328-000-55/76 Rev.01/Rev.04 03-79-926-00 10/20

MONTAGEANLEITUNG

E. SPENDER

3 - MONTAGE der SPENDERRÜCKWAND

3.1 Weiße Rückwand vom Spendergehäuse abziehen...

3.2 ...und diese an den Spenderhalter schrauben mit:
- **e.1** Sicherungsmuttern M5 / SW8 (DIN985)
- **e.2** U-Scheiben ø 5,3 mm
- **e.3** Schrauben M5 x 16 mm (Kreuzschlitz Z2)

3.3 Die Rückwand verfügt über drei Stellen die das Spendergehäuse fixieren:
X - Schlitz: nimmt rechte und linke Schiene auf
Y - Nase: drückt gegen die Gehäuserückwand
Z - Zapfen: taucht in obere quer liegende Schiene

4 - EINHÄNGEN des SPENDERGEHÄUSES

4.1 Gehäuse ansetzen und seitliche Schienen ca. 2 cm in die Schlitze **X** der weißen Rückwand schieben

4.2 Gehäuse nun bis zum Anschlag gegen die Nase **Y** der Rückwand drücken und...

4.3 ...sogleich nach unten schieben bis die obere quer verlaufende Schiene hinter dem Zapfen **Z** der Rückwand festsitzt

5 - HANDHABUNG der PET-FLASCHE

5.1 Flasche unten fassen und nach vorne ziehen bis sie nicht mehr auf dem Haltewinkel **5.a** aufsitzt.

5.2 Flasche langsam nach unten ziehen bis der Saugschlauch nicht mehr eintaucht.

5.3 Flasche nun befüllen mit geeignetem Inhalt:
- Gel, - Desinfektion, - Seife, - Shampoo

5.4 Einbau der Flasche: Saugschlauch eintauchen lassen, Flasche nach oben schieben, auf Haltewinkel **5.a** absetzen und an Rückwand drücken

5.5 Bügel mit Finger, Hand oder Ellenbogen ca. 70 mm nach unten drücken und Füllmittel mit der anderen Hand auffangen.

6 - SPENDER - ABMESSUNGEN

6.1 Geeignet für 500 ml-Flaschen

6.2 Breite: 84 mm


INFORMATIONEN

HINWEIS: Bei Stativ, Spenderhalter und Spender handelt es sich nicht um medizinisch zertifizierte Produkte.


- Negative Auswirkungen des Desinfektionsmittels auf das Produkt (Oberflächen, Material) sind uns nicht bekannt.
- Gleichwohl empfehlen wir, mögliche Rückstände des Desinfektionsmittels stets zu entfernen, um evtl. Schäden zu vermeiden und Sie so lange Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

E. SPENDER


3. Montage der Spenderrückwand

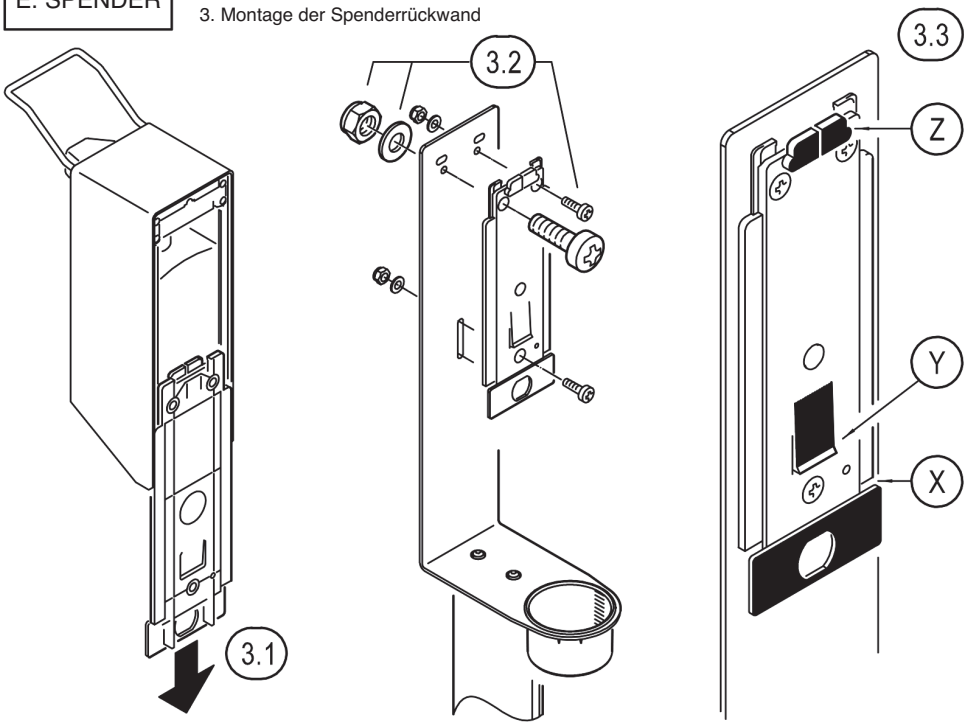


4. Einhängen des Spendergehäuses

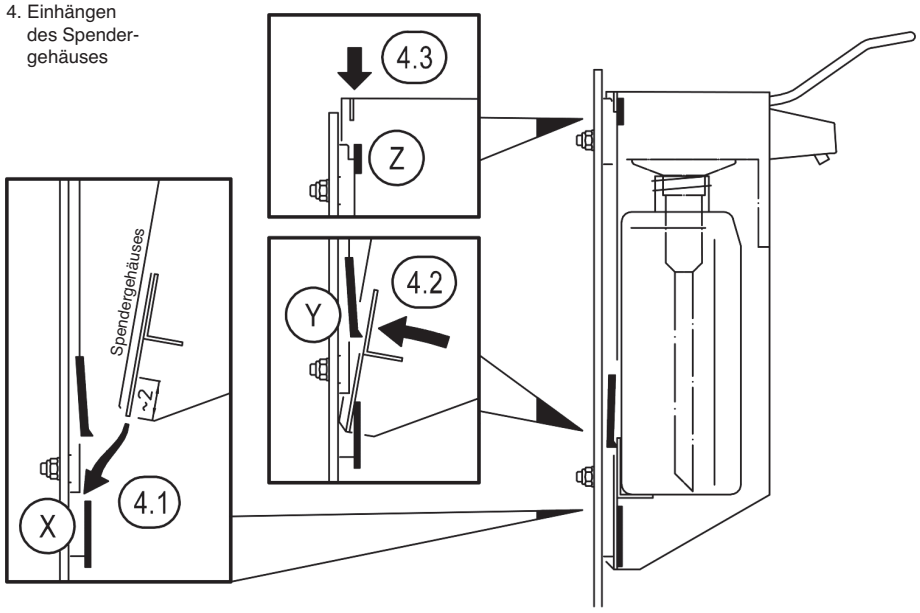

5. Handhabung der Desinfektionsmittelflasche

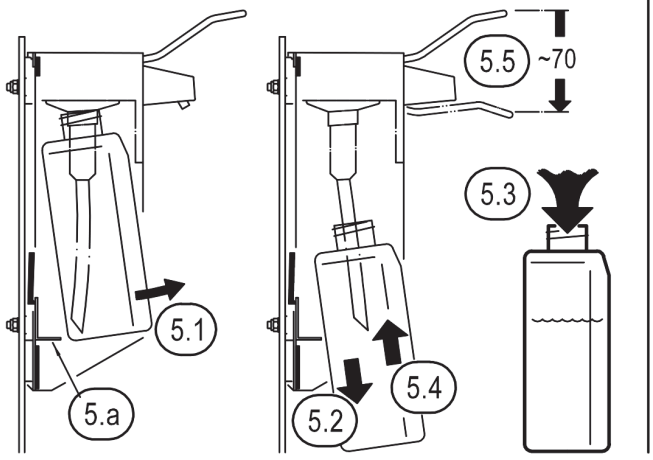

6. Spender - Abmessungen

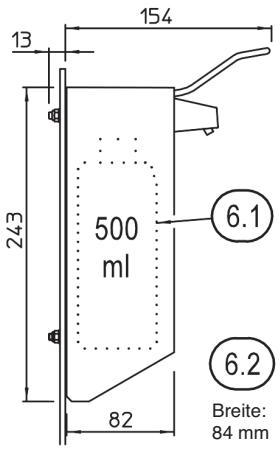

80328 Disinfectant stand including dispenser

KÖNIG & MEYER
Stands For Music

Please read these assembly instructions carefully!

TECHNICAL DATA

STAND

- Total height:	1280 mm
- Height support:	820 mm
- Round base:	ø 275 x 41 mm
- Base tube:	ø 20 x 800 mm
MATERIAL	
- Round base:	steel, galvanized, PA, TPE
- Base tube:	steel
SURFACE	black (-55), powder-coated pure white (-76), powder-coated

DISINFECTANT HOLDER

- Mounting hole patterns for dispensers:	
a. 350/500 ml:	40 x 169 mm
b. 1000 ml:	40 x 203 mm
- drip cup:	ø 70 x 47 mm
MATERIAL	
- Bottle holder:	steel, polyamide
- Thread:	steel, brass, zinc
SURFACE	black (-55), powder-coated pure white (-76), powder-coated

DISPENSER

Elbow dispenser with removable PET bottle

- Dimensions:	W x D x H = 83 x 160 x 243 mm
- Bottle content:	volume = 500 ml
MATERIAL	aluminum, steel, ABS, PET
WEIGHT overall:	5.1 kg

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of the stand depends on the:

GENERAL
Perform visual inspection before use:
Damaged components must not be used - or only after a qualified repair or after an exchange.

ROUND BASE
Handle with care due to the heaviness, in particular, do not drop (danger of crushing).

MOUNTING
Ensure that all screw connection are tight.

SURFACE
Only use the stand on suitable, i.e. level and stable floors.

LOAD
Only for suitable 500ml bottles);
see above TECHNICAL DATA.

SURROUNDINGS
Negative external influences (knocks, dragging around, vibrations, wind, wetness etc.) are to be avoided or prevented.

HANDLING
When changing the direction of the dispenser bottle always turn the entire stand. Never loosen the thread **b.2** of the desinfactant holder **b**.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please carry out a visual check if all parts are complete and as far as visible in order.
Provide the necessary keys.

A. COMPONENTS

a Round base
b Dispenser holder
b.1 Drip cup ø 70 mm
b.2 Threaded bolt M6
c Elbow dispenser with PET bottle
d Base tube
Accessories bag (6-80320-1-00)
e.1 Lock nuts M5-DIN985 (3x) - wrench SW8
e.2 Washer ø 5,3 mm (3x)
e.3 Rounded head screw M5 x 16 mm (3x) - Phillips screw Z2

B. DIMENSIONS


including hole pattern for dispenser mounting:
A. 40 x 169 mm (for 500 ml bottle dispensers included)
B. 40 x 203 mm (for 1000 ml bottle dispensers not included)

C. STAND

1.1 Place the round base (with rubber insert) **a** on the floor,
1.2 screw the base tube **d** with the external thread into the round base **a** as far as it will go.

D. DISINFECTANT HOLDER and DRIP CUP

2.1 Screw in the threaded bolt **b.2** of the dispenser holder **b** into the base tube **d** as far as it will go.
2.2 The drip cup **b.1** can be removed for cleaning purposes. Subsequently press the drip cup from above back into the holder.

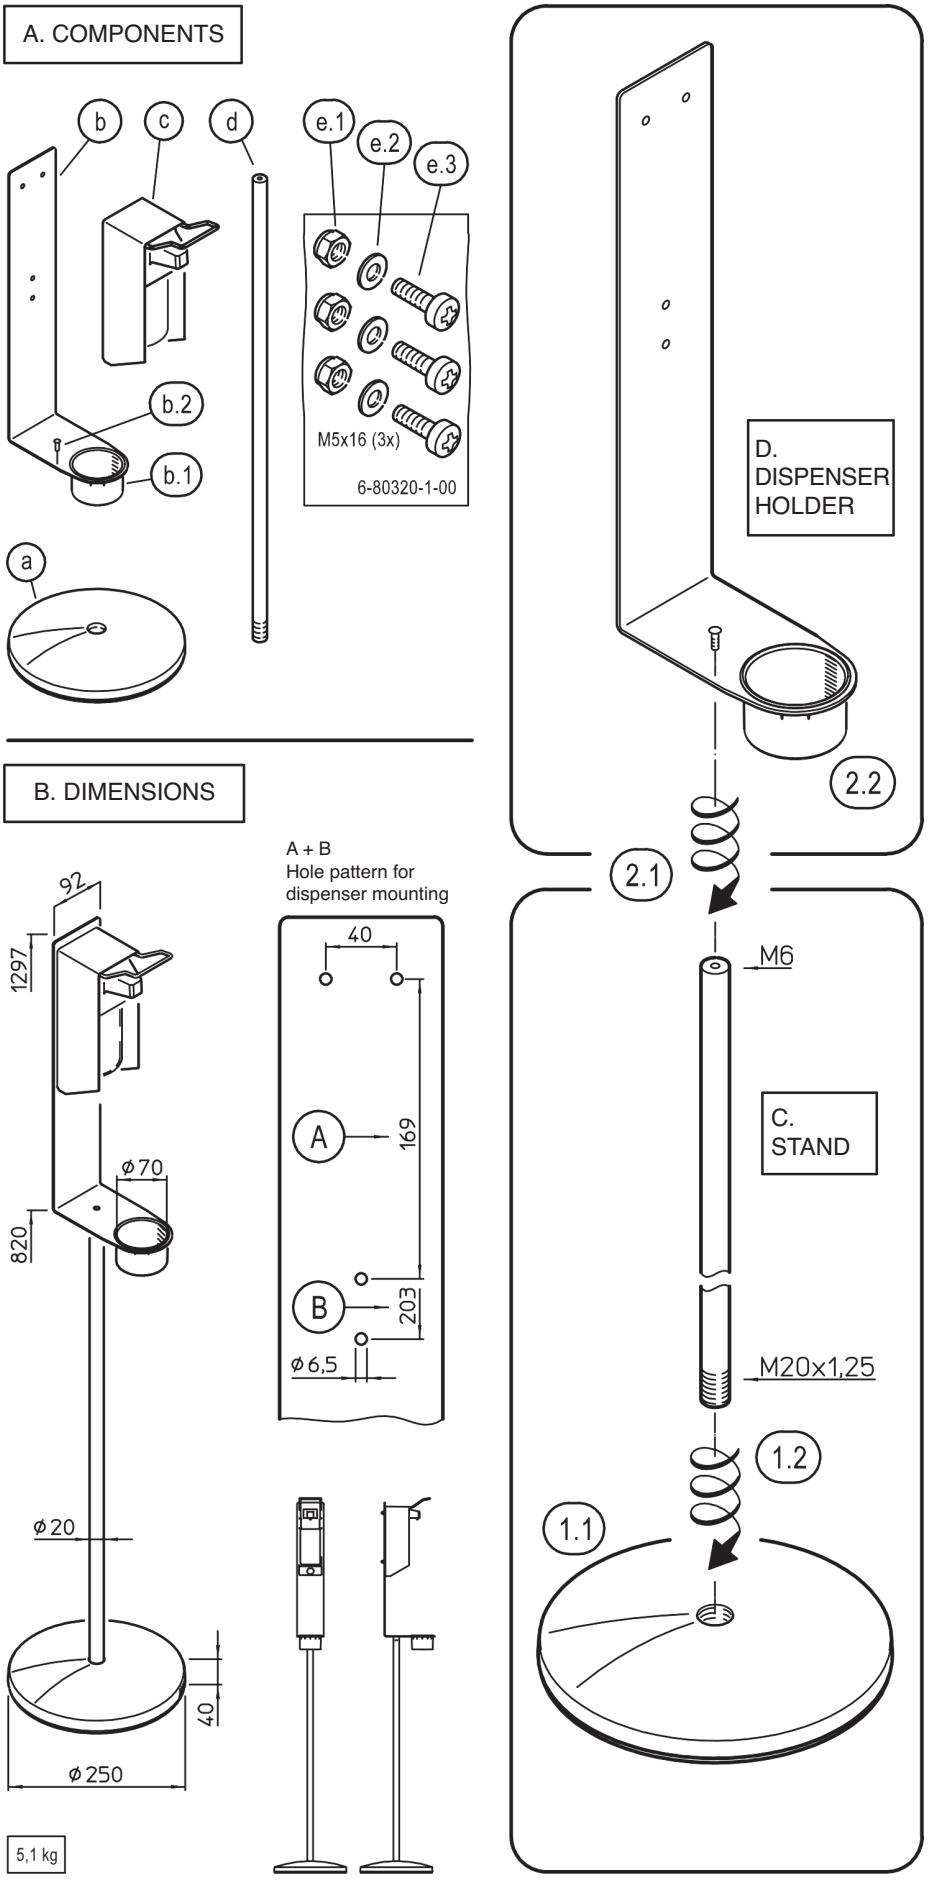

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
80328-000-55/76 Rev.01/Rev.04 03-79-926-00 10/20

INSTALLATION INSTRUCTIONS

E. DISPENSER

3 - MOUNTING the REAR PANEL of the DISPENSER

3.1 Remove the white rear panel from the dispenser housing...

3.2 ...and screw it onto the dispenser holder:
- **e.1** lock nuts M5 / SW8 (DIN985)
- **e.2** washers ø 5,3 mm
- **e.3** screws M5 x 16 mm (Phillips screw Z2)

3.3 The rear panel has three points that fix the dispenser housing:
X - Slot: holds right and left rail
Y - Nose: presses against the rear panel of the housing
Z - Pin: plunges into upper transverse rail

4 - ATTACHING the DISPENSER HOUSING

4.1 Attach the housing and push the side rails approx. 2 cm into the slots **X** in the white rear panel.

4.2 Now press the housing against the nose **Y** of the rear panel as far as it will go and...

4.3 ...immediately push down until the upper transverse rail is fixed behind the pin **Z** of the rear panel

5 - HANDLING the DISINFECTANT BOTTLE

5.1 Grip the bottle at the bottom and pull it forward until it no longer rests on the mounting bracket **5.a**.

5.2 Slowly pull the bottle down until the suction hose is no longer immersed.

5.3 Now fill the bottle with suitable contents:
- gel, - disinfectant, - soap, - shampoo

5.4 Installing the bottle: immerse the suction hose, push the bottle upwards, place it on the mounting bracket **5.a** and press it against the rear panel.

5.5 Press the bow down approx. 70 mm with your finger, hand or elbow and collect the filling material with your other hand.

6 - DISPENSER - DIMENSIONS

6.1 Suitable for 500 ml bottles

6.2 Width: 84 mm


INFORMATION

NOTE: Stand, dispenser holder and dispenser are not medically certified product.


- Negative effects of the disinfectant on the products (surfaces, material) are not known to us.
- Nevertheless, we recommend to always remove possible residues of the disinfectant in order to avoid possible damage and to enjoy the product as long as possible.
- For cleaning purposes use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.

D. DISPENSER


3. Mounting the rear panel of the dispenser

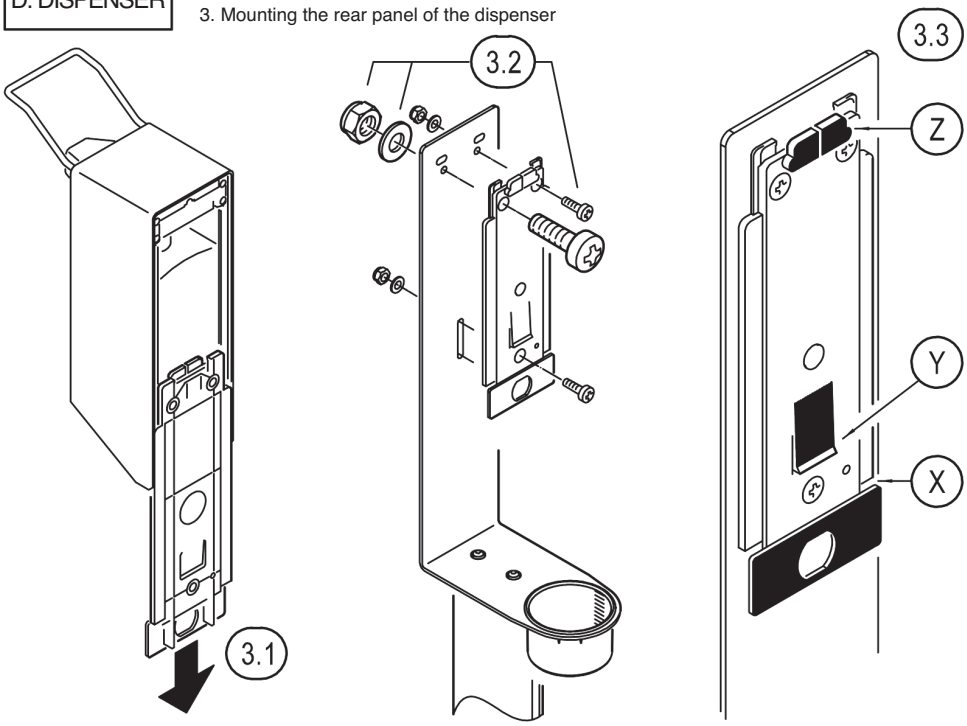

4. Attaching the dispenser housing

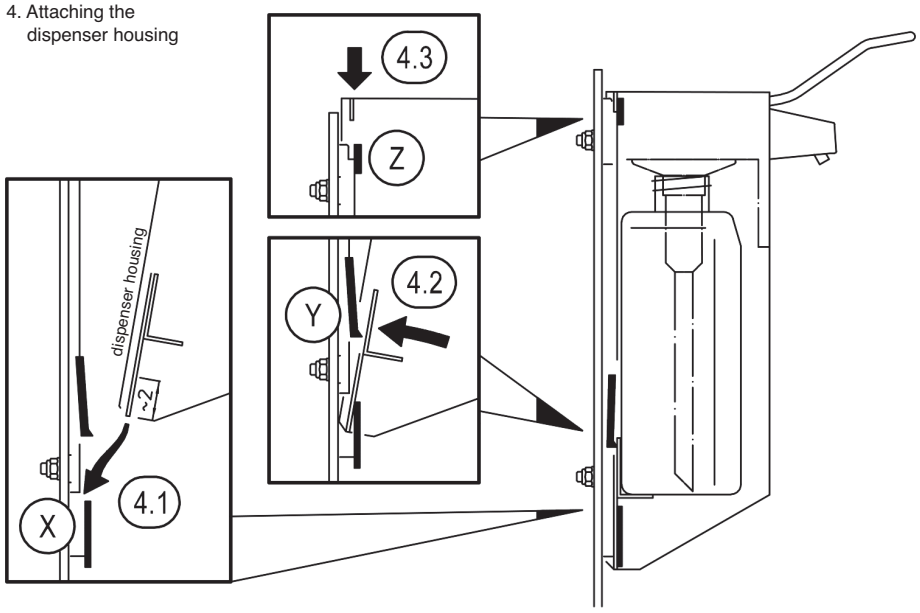

5. Handling the disinfectant bottle

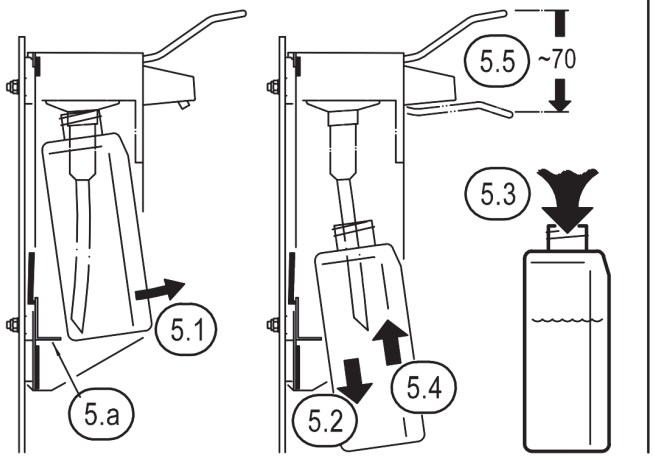

6. Dispenser - Dimensions

